


TANITA®

Monitoring Your Health

Digital Scale for kitchen use

MODEL KD-192

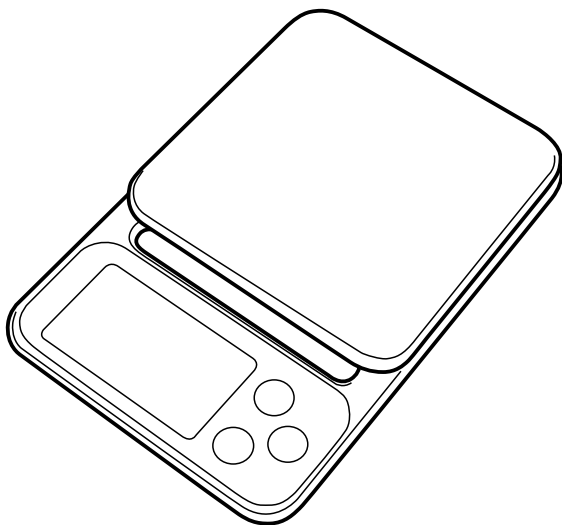

(EN) Instruction Manual

Read this Instruction Manual carefully and keep it for future reference.

(ZH) 電子秤使用手冊

請仔細閱讀本說明手冊，並妥善保存以作為日後的參考。

(TH) คู่มือการใช้งานเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล

กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และจัดเก็บเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

(ID) Petunjuk Manual


Silahkan membaca Manual Instruksi ini dengan seksama dan simpan untuk referensi mendatang.

Important

Use the scale on a firm, flat surface.


1. The scale is a precision instrument. Do not dismantle the scale and avoid strong vibrations or shocks.
2. Keep away from direct sunlight and heating appliances, eg. oven.
3. When moving the scale to a new location, where the temperature differs from the previous location by more than 10°C (50°F), leave the scale in the new location for at least 2 hours before using it.
4. Wipe the scale clean with a damp cloth.
5. Avoid using chemicals to prevent creating a hazard.
6. If the scale is not to be used for a long period of time, remove the batteries.

Name of parts

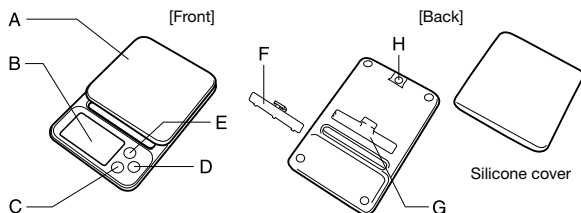


A	Tray
B	LCD
C	TARE/Micro Mode button
D	ON/OFF button
E	g/ml button
F	Lid (Battery compartment)
G	Battery compartment
H	Hook hanger

[Details of Display]

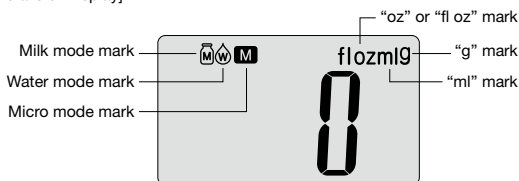

How to use


◆ Battery placement

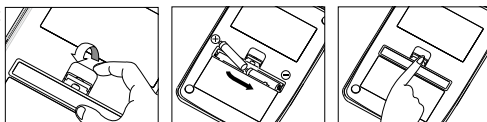

Insert 2×“AAA” “R03” or “24F” batteries as indicated.

◆ Hanging hook

Hang directly using the retractable hanging hook.

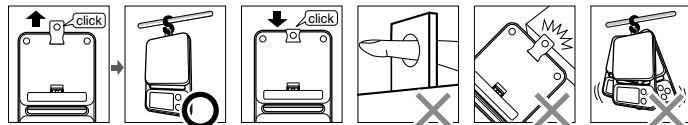


When not using the hook hanger, press it into the scale until it clicks for storage.



Do not hang the scale in a location where it can swing or drop easily, or in an otherwise unstable place. Doing so may damage the scale or cause injury due to the scale colliding with another object or dropping from the hook. Also, do not use a suction pad hook, double-sided tape hook, or weak magnet hook. Such hooks may not be able to support the weight of the scale, causing it to fall.

◆Weighing/Tare function


If the weight of the item(s) exceeds the scale's capacity, "EEEE" will appear on the display. Make sure item (s) is placed in the center of the tray.




Press ON/OFF.




Place a bowl on the tray.



Press TARE/ Micro to subtract the weight of the bowl.



Place the material to be weighed.




After removing the bowl, the display will show a negative reading or "----". Press the TARE/ Micro to return the display to "0". Press ON/OFF to turn off.


◆Micro Mode

This scale has a micro mode which enables finer measurements.



g version



- * Press  when 0.0 g or 0.00 oz is displayed, then the display returns to the normal measurement mode (1 g display).
- * This is the same when ml is displayed.



oz version




* The minimum display unit in the micro mode changes depending on the total weight on the tray. (Weight after tare weighing is included.)

Total weight on the tray	Displayed unit
0 to 200 g/0 to 7.05 oz	0.1 g/0.01 oz
200 to 1000 g/7.06 to 35.28 oz	0.5 g/0.02 oz
1000 to 2000 g/35.30 to 70.5 oz	1 g/0.05 oz


⚠ Caution

Once the total weight becomes 200 g or more, the weight is displayed in 0.5 g units even if the item to be weighed is removed. In the same way, once the weight total becomes 1000 g or more, the weight is displayed in 1 g units.


(Example)




In the micro mode.




When weight is 1000 g or more, it is displayed in 1 g units.



Remove a portion of it.



When TARE/Micro is pressed, 0 is displayed.



When TARE/Micro is pressed again, 0.0 g is displayed. In this case, the container is 750 g, so it can be measured in 0.5 g units.

◆ Unit switching

1. g (oz) ↔ ml (fl oz)

Besides normal weight (g or oz), a milk or water container (ml, fl oz) can be measured with this scale without a measuring cup. 1 cc is 1 ml, so cc can be measured in the same way.


* Milk means normal milk. Normal milk stands for raw milk.

Please note that the conversion of "g" to "ml" may differ as the density and weight of milk varies among different species and manufactures.


* Please measure water or normal milk at temperatures of 40°C or less.

* It also can be used in the micro mode.

[g version]

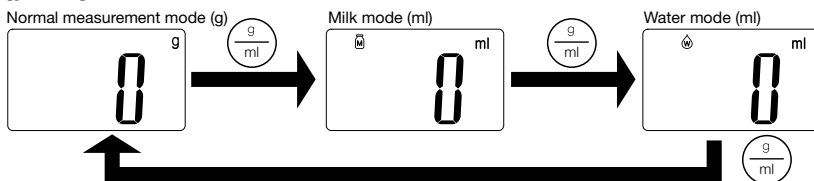

[oz version]

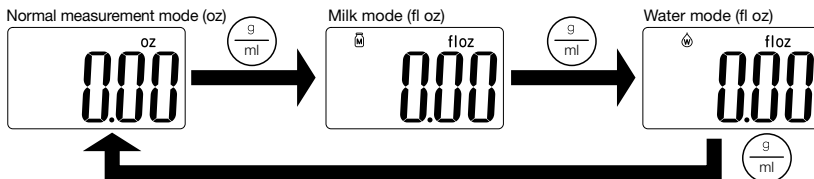

2. g ↔ oz

When the power is ON, press TARE/Micro button while pressing g/ml button, select the proper mode. (for the g/oz version)




◆Auto Power Off

The scale is designed with an auto power-off function for energy efficiency. If the same reading is displayed for more than 10 minutes the scale will automatically turn off.

◆Battery replacement

If "Lo" appears in the display when attempting to weigh, replace the battery. (following previous instructions)

Trouble shooting

- The power doesn't turn on.**
 Insert 2 new size AAA ("R03" or "24F") batteries. Be sure that the polarity of the batteries is set properly.
- "Err6" or "Err7" appears on the display.**
 The scale needs to be repaired. Please contact your retailer.
- "Err1" or "Err8" appears on the display.**
 Place the container or item(s) only after 0 g/0.00 oz is displayed.
- The scale does not set to micro mode/M mark disappears while operating.**
 Minimum display is 1 g/0.05 oz when the total weight on the tray is 1000 g/35.28 oz or more.
 Press  again after removing the weight.
- Although Micro Mode was selected, the weight of something less than 200g/7.05oz cannot be shown in 0.1 g/0.01 oz increment.**
 Has the scale display ever shown 0 g after pressing  during additional measurement? If the answer is "Yes", that means the total weight on the scale has reached/exceeded 1000 g/35.28 oz. Once the total weight reached/exceed 200 g/7.05 oz, the scale increment will automatically change to 0.5 g/0.02 oz even if is pressed during additional measurement. By the same token, when total weight reached/exceeded 1000g/35.28oz, the increment will change to 1g/0.05oz.
 To reset the scale to Micro Mode, simply remove all the materials from the tray, then press  to show 0.0 g/0.00 oz.

Specification


		g version		g/oz version	
Capacity		2000 g		2000 g / 70.5 oz	
Graduation	Normal measurement mode	1 g		1 g / 0.05 oz	
	Micro mode	0 – 200 g	0.1 g	0 – 200 g	0.1 g
		200 – 1000 g	0.5 g	0 – 7.05 oz	0.01 oz
				200 – 1000 g	0.5 g
				7.06 – 35.28 oz	0.02 oz

重要

請在平穩地方使用。


1. 此為精密衡器，請勿嘗試拆開及強烈搖擺或撞擊。
2. 避免陽光直接照射，並遠離發熱電器如電爐。
3. 如此電子秤需移往不同地方使用，而溫差多於攝氏 10 度（華氏 50 度）。請先擺放 2 小時，然後才使用。
4. 可用濕毛巾清潔。
5. 避免使用化學清潔劑。
6. 如長時間不使用，請移除電池。

零件名稱

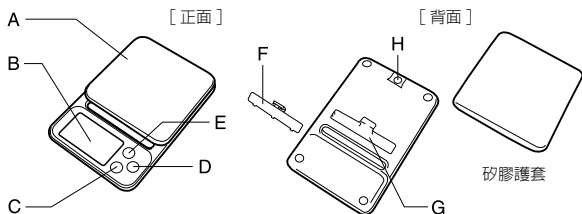


A	托盤
B	LCD
C	TARE/Micro 模式按鈕
D	ON/OFF 按鈕
E	g/ml 按鈕
F	Lid (電機匣)
G	電機匣
H	掛鉤

[顯示幕的細節]

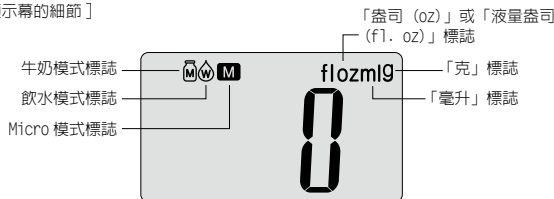

使用方式


◆ 更換電池

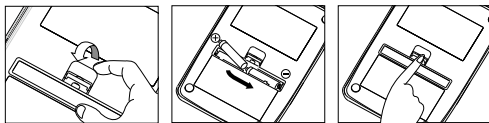

如圖所示放入兩顆「AAA」、「R03」或「24F」電池。

◆ 掛鉤

可利用能收藏的掛鉤而直接掛起磅秤。

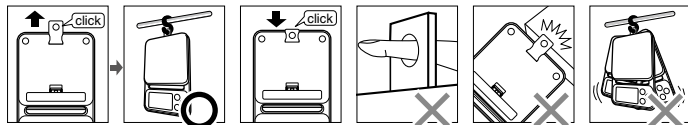


當不使用掛鉤時，可將掛鉤壓入磅秤內存放。

請勿將磅秤懸掛於會搖擺、容易掉落、或不穩定的地方。其原因在於磅秤會與其它物體碰撞或自掛鉤上掉落而可能損及磅秤或造成受傷。此外，也不要使用黏有吸力墊或雙面膠帶的掛鉤、或弱磁性的掛鉤。這類掛鉤可能無法支撐磅秤的重量而使磅秤掉落。



◆ 秤重 / 容器重量功能

倘若物件重量超過磅秤容量時，畫面上就會出現「EEEE」。請確定您將物件放置在托盤中央。

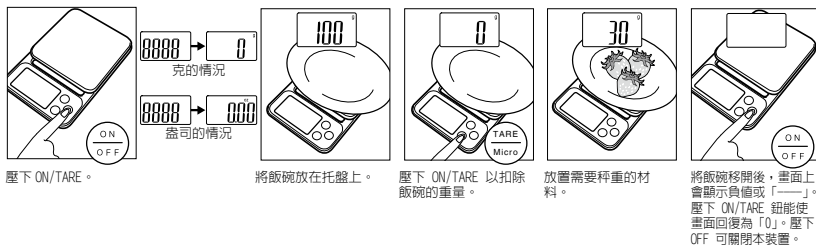

◆ Micro 模式

本磅秤含有 Micro 模式，可做更精密的測量。




* Micro 模式時的最小顯示單位會隨著托盤上的總重量而改變。（包含容器重量後的重量值。）

托盤上的總重量	顯示單位
0 - 200 g/0 - 7.05 oz	0.1 g/0.01 oz
200 - 1000 g/7.06 - 35.28 oz	0.5 g/0.02 oz
1000 - 2000 g/35.30 - 70.5 oz	1 g/0.05 oz

注意

當總重量為 300g 或更重，且即便拿開要秤重的物品後，仍會以 0.4g 為單位來顯示重量。以同樣的方式，當總重變成 1500g 或更重時，會以 1g 為單位來顯示重量。

(範例)

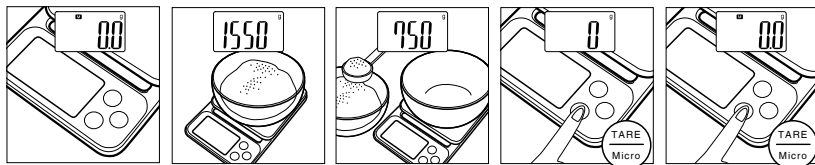

Micro 模式

當重量為 1500g 或更重時，會以 1g 為單位來顯示重量。

將重量的一部分移除。

當按下 **TARE/Micro** 時，會顯示 0。

再次按下 **TARE/Micro** 時，會顯示 0.0g。此例中的容器重 750g，因此會以 0.5g 為單位測量該容器的重量。

◆單位的切換

1. 克 (盎司) ↔ 毫升 (液量盎司)

除了普通的重量 (單位: 克或盎司) 外, 可不必使用量杯就能利用本磅秤測量裝有牛奶或水的容器 (單位: 毫升或液量盎司)。1cc 就是 1 毫升, 故可採用同樣方式測量 cc 值。

* “牛奶” 定義為普通牛奶; 即為生乳。

請注意單位 “克” 和 “毫升” 轉換可能因不同生產商與種類的牛奶密度有所差異。

* 請使用溫度為 40 °C 或低於 40 °C 的水或普通牛奶。

* Micro 模式下也可以使用。

[克的情況]



[盎司的情況]



2. g ↔ oz

如需更換模式, 按下 “ON/TARE” 鍵持續 2 秒顯示 “g” 或 “oz”。





◆ 自動關閉電源

本磅秤設計了自動關閉電源功能以達到節能目的。倘若顯示相同讀數超過 10 分鐘時，就會自動關閉磅秤電源。

◆ 更換電池

倘若要秤重時畫面上出現「Lo」的話，就應更換電池。（參照先前的說明）

故障排除

- **無法啟動電源**
裝入兩顆新的 AAA（「R03」或「24F」）電池。確定正確安裝電池的極性。
- **畫面上出現「Err6」或「Err7」**
磅秤需要修理。請連繫您的零售商。
- **顯示幕上會出現「Err 1」或「Err8」。**
顯示 0g/0.00oz 後，就可以放上容器或材料。
- **本磅秤並未設定為 Micro 模式。/ 進行操作時，M 標誌會消失。**
最低顯示值為 1g/0.05oz。當托盤上的總重為 1500g / 52.9oz 或更重時，移開該重量後再按下 。
- **儘管在 Micro 模式時的重量為 300g/10.58oz 或更輕，但不會顯示出 0.1g/0.01oz 的單位。**
在在附加秤重時，當按  鍵後，如果電子秤顯示“0g”；即代表電子秤已達到或超過 1000g / 35.28oz。
在在附加秤重時，當總重量達到或超過 200g / 7.05oz 後，儘管按下  鍵，電子秤會自動把顯示單位轉換成 0.5g 或 0.02oz。如此類推，當總重量達到或超過 1000g / 35.28oz 時，顯示單位會轉換成 1g / 0.05oz。
要重新設定“Micro 模式”；請移除所有秤盤上的物品；再按  鍵；顯示就會重設為 0.0g / 0.00oz。

規格


		g（克）版本		g/oz（克 / 安士）版本	
容量		2000g		2000g / 70.5oz	
刻度	正常測量模式	1 g		1g / 0.05oz	
	Micro 模式	0 — 200g 200 — 1000g	0.1g 0.5g	0 — 200g 0 — 7.05oz 200 — 1000 g 7.06 — 35.28oz	0.1g 0.01oz 0.5g 0.02oz

สำคัญ

วางเครื่องชั่งน้ำหนัก บนพื้นราบที่มีความแข็งแรง


1. เพื่อให้เครื่องชั่งน้ำหนักแม่นยำ ไม่ควรถอดชิ้นส่วนประกอบของเครื่องชั่ง และหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทก
2. เก็บเครื่องชั่งให้พ้นจากแดดโดยตรง และเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่นเตาอบ
3. เมื่อย้ายเครื่องชั่งน้ำหนักจากที่มีแสงแดดและร้อนจนเกินไป ไปยังที่ใหม่ ซึ่งมีอุณหภูมิมากกว่า 10 องศาเซลเซียส (50 องศาฟาเรนไฮต์) ควรทิ้งเครื่องชั่งน้ำหนัก ไว้ 2 ชั่วโมง ก่อนใช้งานอีกครั้ง
4. เช็ดทำความสะอาดเครื่องชั่งด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ
5. เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกับเครื่องชั่งน้ำหนัก
6. หากไม่ได้ใช้เครื่องชั่งน้ำหนักเป็นเวลานาน ควรถนอมแบตเตอรี่ออก

ส่วนประกอบ

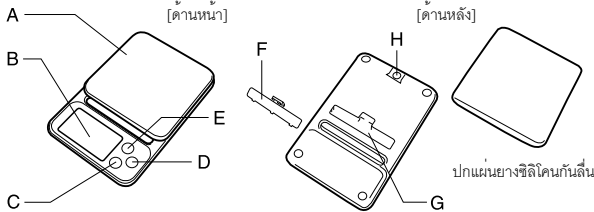




A	ฝาปิด
B	จอ LCD
C	ปุ่ม TARE/Micro Mode
D	ปุ่ม ON/OFF
E	ปุ่ม g/ml (กรัม/มิลลิลิตร)
F	Lid (ช่องใส่แบตเตอรี่)
G	ช่องใส่แบตเตอรี่
H	ตะขอเกี่ยว

[รายละเอียดของการแสดงผล]

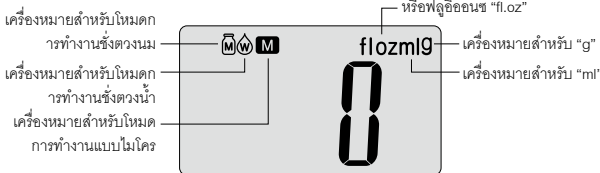

วิธีการใช้


◆การเปลี่ยนแบตเตอรี่



ใส่แบตเตอรี่ "AAA" "R03" หรือ "24F"x2 ตามที่ระบุไว้

◆ตะขอ

ตะขอเกี่ยว ติดกับตัวเครื่องชั่งโดยตรงสำหรับ ไรแขวนเพื่อเก็บเครื่องชั่งน้ำหนัก

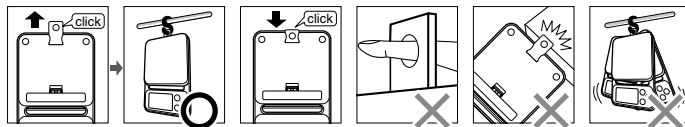


เมื่อไม่ใช้งานตะขอ ดันตะขอเพื่อพับเก็บในช่องเก็บด้านหลัง ตามภาพ

ไม่แขวนเครื่องชั่งไว้ในที่ที่สามารถแกว่งได้ ตกได้ง่าย หรือที่ไม่นิ่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการชำรุดหรือเสียหายจากการตกลงหรือการปะทะกับ วัตถุอื่น และไม่ควรวางเครื่องชั่งโดยการไขแฉกเกี่ยว เทปกาบสองหน้าหรือแม่เหล็กที่ไม่มีความแข็งแรงเพียงพอ เนื่องจากวัสดุดังกล่าวอาจไม่สามารถรับน้ำหนักของเครื่องชั่งได้ และอาจทำให้เครื่องชั่งตกลงลงมาได้

◆การชั่งน้ำหนัก/ ฟังก์ชัน Tare

กรณีชั่งน้ำหนักสิ่งของเกินกว่า พิกัดน้ำหนักสูงสุดของเครื่องชั่ง จะแสดงสัญลักษณ์ "EEEE"
วางสิ่งของที่จะชั่งไว้ตรงกลางถาด

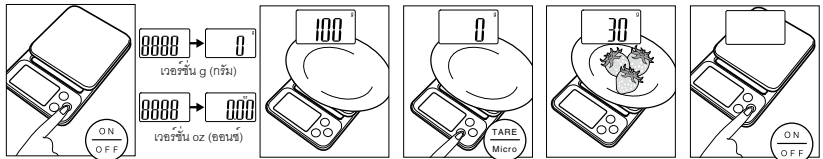

กดปุ่ม ON/TARE

วางชามโบนถาด


กดปุ่ม ON/TARE เพื่อทำการ
ชั่งน้ำหนักของชาม

ใส่สิ่งของที่ต้องการจะชั่ง


เมื่อชามชอง หน้าจอแสดง
ค่าติดลบ หรือ "..." กดปุ่ม
ON/TARE เพื่อตั้งค่าน้ำหนัก
กลับเป็น "0" จากนั้นกดปุ่ม OFF
เพื่อเปิดเครื่อง

◆โหมดการทำงานแบบไมโคร

เครื่องชั่งน้ำหนักนี้มีโหมดการทำงานแบบไมโครที่สามารถใช้ทำการชั่งตวงที่ละเอียดมากขึ้น



เวอรชั่น g (กรัม)



เวอรชั่น oz (ออนซ์)

* กด เมื่อเครื่องแสดงค่า 0.0g (กรัม) หรือ 0.00oz (ออนซ์) หลังจากมีการแสดงผลจะกลับสู่โหมดการชั่งแบบปกติ (แสดงในรูป 1g (กรัม))

* ให้ทำเช่นนี้เหมือนกันเมื่อเครื่องแสดงค่าเป็น ml (มิลลิลิตร)


* โหมดการทำงานแบบไมโครนั้น หน่วยงานในการแสดงผลจะเปลี่ยนตามน้ำหนักทั้งหมดบนถาด (รวมน้ำหนักหลังจากที่เทกลับน้ำหนักชามนะ)

น้ำหนักทั้งหมดบนถาด	หน่วยที่แสดงผล
0 - 200 g/0 - 7.05 oz	0.1 g/0.01 oz
200 - 1000 g/7.06 - 35.28 oz	0.5 g/0.02 oz
1000 - 2000 g/35.30 - 70.5 oz	1 g/0.05 oz


⚠ คำเตือน

หากน้ำหนักรวมนั้นหนัก 300g (กรัม) หรือมากกว่า เครื่องจะแสดงค่าในหน่วย 0.4g (กรัม) แม้ว่าจะมีการนำวัตถุที่ซึ่งออกจากเครื่องชั่งน้ำหนักแล้วก็ตาม เช่นเดียวกัน หากน้ำหนักรวมหนัก 1500g(กรัม) หรือมากกว่านั้น เครื่องจะแสดงค่าในหน่วย1.5g (กรัม)


(ตัวอย่าง)




ในโหมดการทำงานแบบไมโคร




หากน้ำหนักหนัก 1500g (กรัม) หรือมากกว่านั้น เครื่องจะแสดงค่าในหน่วย 1.5g (กรัม)



นำบางส่วนออก



เมื่อกด **TARE** เครื่องจะแสดงค่า 0



เมื่อมีการกด **TARE** อีกครั้ง เครื่องจะแสดงค่า 0.0g (กรัม) ในกรณีที่น้ำหนักที่บรรจุมีหนัก 750g (กรัม) ดังนั้นจึงสามารถชั่งตวงได้ ในหน่วย 0.5g (กรัม)

◆ การเปลี่ยนหน่วย

1.g (กรัม) /oz (ออนซ์) ↔ ml (มิลลิลิตร) /fl.oz (ฟลูอิด ออนซ์)

นอกจากการชั่งน้ำหนักแบบธรรมดา (g (กรัม) /oz (ออนซ์)) เครื่องชั่งน้ำหนักยังสามารถชั่งภาชนะที่บรรจุผงหรือน้ำ (ml (มิลลิลิตร), fl.oz (ฟลูอิด ออนซ์)) โดยไม่ต้องใช้ถ้วยตวง 1cc (ซีซี) เท่ากับ 1 ml (มิลลิลิตร) ดังนั้นจึงสามารถวัด cc (ซีซี) ได้ด้วยวิธีเดียวกัน

* นม หมายถึง น้ำนมดิบธรรมชาติ ที่ยังไม่มีการปรุงแต่งรส, สี และกลิ่น


การแปลงจากหน่วย "g" (กรัม) เป็น "ml" (มิลลิลิตร) จะมีความแตกต่างกันของความหนาแน่นและน้ำหนักของนมที่ต่างกันในกลุ่มสายพันธุ์และภาวะผลิต

* กรุณาใช้น้ำหรือนมธรรมดาที่อุณหภูมิ 40°C (องศาเซลเซียส) หรือต่ำกว่านั้น


* นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานโหมดการทำงานแบบไมโครได้

[เวอร์ชัน g (กรัม)]


โหมดการทำงานแบบการชั่งธรรมดา
(g (กรัม))



โหมดการทำงานชั่งตวงนม
(ml (มิลลิลิตร))





โหมดการทำงานชั่งตวงน้ำ
(ml (มิลลิลิตร))





[เวอร์ชัน oz (ออนซ์)]


โหมดการทำงานแบบการชั่งธรรมดา
(oz)



โหมดการทำงานชั่งตวงนม
(fl oz)



โหมดการทำงานชั่งตวงน้ำ
(fl oz)



2. g ↔ oz

เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดจาก "g" เป็น "oz" ให้กดปุ่ม ON/TARE ค้างไว้ 2 วินาที เพื่อเลือกโหมดเป็น กรัม หรือ ออนซ์

◆ ปิดอัตโนมัติ

เครื่องซึ่งออกแบบมาพร้อมกับฟังก์ชันการปิดอัตโนมัติ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน หากเครื่องซึ่งน้ำหนักอ่านค่าน้ำหนักเพียงค่าเดียวและไม่มีการชั่งน้ำหนักอื่นอีก เครื่องซึ่งน้ำหนักจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

◆ การเปลี่ยนแบตเตอรี่

เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อหน้าจอปรากฏ "Lo" (ตามรายละเอียดการเปลี่ยนแบตเตอรี่หน้าแรก)

การแก้ไขปัญหา

• หากไม่สามารถเปิดเครื่องได้

เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ 2 ก้อน ขนาด AAA ("R03" หรือ "24F") , ตรวจสอบขั้วของแบตเตอรี่ว่าถูกต้องหรือไม่


• หากปรากฏ "Err6" หรือ "Err7"

ติดต่อผู้แทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการ


• หากเครื่องแสดงค่า "Err 1" หรือ "Err8"

ในทางภาชนะหรือสิ่งของหลังจากที่เครื่องแสดงค่า 0g(กรัม)/0.00oz (ออนซ์)

• เครื่องซึ่งไม่ได้ตั้งค่าที่โหมดการทำงานแบบไมโคร / ขณะใช้งาน เครื่องหมาย M จะหายไป

การแสดงค่าขั้นสุดคือ 1g(กรัม)/0.05oz(ออนซ์) เมื่อน้ำหนักรวมทั้งหมดบนถาดชั่งน้ำหนักหน้า 1500g(กรัม)/52.9oz(ออนซ์) หรือมากกว่า ให้กด  อีกครั้งหลังจากที่นำวัตถุออกจากที่ชั่ง

• ในโหมดการทำงานสำหรับการวัดแบบไมโคร แม้ว่าน้ำหนักจะหนัก 300g(กรัม)/10.58 oz(ออนซ์) หรือน้อยกว่าก็ตามเครื่องจะไม่แสดงค่าในหน่วย 0.1g(กรัม)/ 0.01oz(ออนซ์)

หน้าจอเครื่องซึ่งแสดงผล 0g หลังจากทีกดปุ่ม  ในขณะที่มีการชั่งน้ำหนักเพิ่มหรือไม่ ถ้าคำตอบคือ "ใช่" นั้นหมายความว่าน้ำหนักรวมบนเครื่องซึ่ง ชั่งได้ ถึง หรือ เกิน 1000g/35.28oz.

เมื่อรวมน้ำหนักถึง หรือ เกิน 200g/7.05oz. เครื่องซึ่งเปลี่ยนอัตโนมัติ เป็น 0.5g/0.02oz.

แม้ว่ามีการกดปุ่ม  ในระหว่างการชั่งเพิ่ม

ในท่านองเดียวกัน เมื่อน้ำหนักรวม ถึง หรือ เกิน 1000g/35.28oz. เครื่องซึ่งเพิ่มเปลี่ยนเป็น 1g/0.05oz.

เมื่อต้องการตั้งค่าเครื่องซึ่งเป็น โหมดไมโคร เพียงกดปุ่มทั้งหมด

ออกจากถาดแล้วกดปุ่ม  เครื่องซึ่งแสดง 0.0g/0.00oz.

คุณสมบัติ


		เวอร์ชัน g (กรัม)	เวอร์ชัน oz (ออนซ์)
น้ำหนักสูงสุดที่รับได้		2000g	2000g / 70.5oz
การชั่งตวง	โหมดการทำงานสำหรับการวัดแบบธรรมดา	1g	1g / 0.05oz
	โหมดการทำงานสำหรับการวัดแบบไมโคร	0 – 200g 200 – 1000g	0.1g 0.01oz 0.5g 0.02oz

Penting

Gunakan alat di ruangan dan permukaan yang datar.


1. Timbangan jangan dibongkar, hindari getaran atau guncangan keras.
2. Jauhkan dari sinar matahari dan suhu panas.
3. Jika memindahkan timbangan ke tempat lain dengan perbedaan suhu lebih dari 10°C (50°F), diamkan timbangan minimal 2 jam sebelum digunakan.
4. Bersihkan timbangan dengan kain lembab.
5. Hindari penggunaan dengan bahan kimia untuk menghindari bahaya.
6. Jika timbangan tidak digunakan dalam jangka waktu lama, lepaskan baterai.

Nama bagian

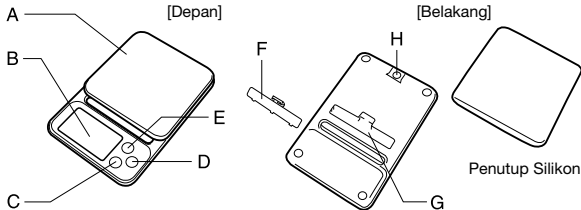


A	Nampan
B	LCD
C	Tombol Mode TERA/ Mikro
D	Tombol ON/OFF
E	Tombol g/ml
F	Lid (Tempat Baterai)
G	Tempat Baterai
H	Penggantung kaitan

[Detil Tampilan]

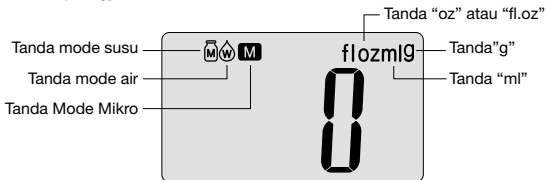

Cara penggunaan


◆Penggantian baterai

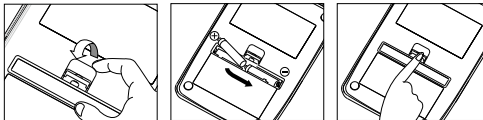

Masukan 2x baterai "AAA" "R03" atau "24F" seperti yang dijelaskan.

◆Kait Penggantung

Gantung langsung menggunakan kait penggantung yang dapat ditarik kembali.

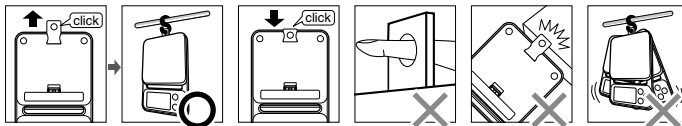


Ketika tidak menggunakan kait penggantung, tekan kait ke dalam timbangan untuk disimpan.


Jangan menggantung timbangan di tempat yang dapat menyebabkan timbangan terayun, mudah jatuh, atau tidak stabil. Hal tersebut dapat merusak timbangan atau menyebabkan kecelakaan akibat terbenturnya timbangan dengan barang lain atau terjatuhnya timbangan dari kait penggantung. Jangan menggunakan kait mangkuk penyedot, kait selotip dua sisi, atau kait bermagnet lemah. Kait-kait seperti itu tidak kuat menahan berat timbangan, menyebabkan jatuh.

◆ Fungsi Menimbang/mentara


Jika berat barang yang ditimbang melebihi kapasitas timbangan, "EEEE" akan muncul di layar. Pastikan Anda meletakkan barang yang ditimbang di tengah baki timbangan.




Tekan ON/TARE.




Versi g




Versi oz




Letakkan mangkuk di atas baki.



Tekan ON/TARE untuk mengurangi berat mangkuk.




Letakkan bahan yang akan ditimbang.




Setelah mangkuk dipindahkan, layar akan menunjukkan hasil pengukuran negatif atau "----". Tekan tombol ON/TARE untuk mengembalikan layar ke "0". Tekan OFF untuk mematikan.


◆ Mode Mikro

Timbangan ini memiliki mode mikro yang dapat mengukur lebih teliti



Versi g



* Tekan  ketika 0.0 g atau 0.00 oz ditampilkan, kemudian layar kembali ke mode pengukuran normal (tampilan 1 g).

* Hal yang sama ketika ml ditampilkan.



Versi oz



* Satuan tampilan minimum dalam mode mikro berubah tergantung pada total berat di nampian. (Termasuk berat setelah peneraan)


Total berat di nampian	Satuan yang ditampilkan
0 - 200 g/0 - 7.05 oz	0.1 g/0.01 oz
200 - 1000 g/7.06 - 35.28 oz	0.5 g/0.02 oz
1000 - 2000 g/35.30 - 70.5 oz	1 g/0.05 oz



Perhatian

Ketika berat total mencapai 300g atau lebih, berat ditampilkan dalam satuan 0.4g walaupun bahan yang akan ditimbang dipindahkan. Dengan cara yang sama, ketika berat total mencapai 1500g atau lebih, berat ditampilkan dalam satuan 1 g.


(Contoh)




Dalam mode mikro.




Ketika berat mencapai 1500 g atau lebih, berat ditampilkan dalam satuan 1 g.



Pindahkan sebagian dari itu.



Ketika TARE/Micro ditekan, 0 ditampilkan.



Ketika TARE/Micro ditekan kembali, 0.0 g ditampilkan. Dalam hal ini, wadah seberat 750 g, sehingga dapat diukur dalam satuan 0.5 g.

◆PENGANTIAN SATUAN

1.g (oz) ↔ ml (fl.oz)

Selain berat normal (g atau oz), wadah susu atau air (ml, fl, oz) dapat diukur menggunakan timbangan ini tanpa cangkir pengukur. 1 cc adalah 1 ml, sehingga cc dapat diukur dengan cara yang sama.


* Susu berarti susu Murni . Susu Murni terdapat pada susu mentah. Harap di catat bahwa perubahan " g " untuk " ml " dapat berbeda sebagai kepadatan dan berat susu bervariasi antara beda jenis dan pembuatannya.

* Silahkan menggunakan air atau susu normal pada suhu 40°C atau kurang.


* Dapat juga digunakan dalam mode mikro.

[Versi g]

Mode pengukuran normal (g)



Mode susu (ml)




Mode air (ml)




[Versi oz]

Mode pengukuran normal (oz)



Mode susu (fl oz)



Mode air (fl oz)



2. g ↔ oz

Jika membutuhkan penggantian MODE, tekan dan tahan tombol ON/TARE kira-kira 2 detik. Sampai layar menunjukkan "g" atau "oz" (untuk versi g dan oz).

◆Auto Power OFF

Timbangan di desain dengan fungsi auto Power off untuk efisiensi energi. Jika tampilan yang sama tidak berubah dalam 10 menit, timbangan akan otomatis OFF.

◆Penggantian baterai

Jika "Lo" muncul di layar ketika menimbang, silahkan ganti baterai. (menurut instruksi berikut)

Pemecahan masalah

• Timbangan tidak bisa menyala.

Masukan 2 baterai baru ukuran AAA ("RO3 atau "24F"). Pastikan baterai terpasang dengan polaritas yang benar.

• "Err6" or "Err7" muncul di layar.

Timbangan perlu diperbaiki. Silahkan menghubungi toko retail tempat Anda membeli timbangan.


• "Err 1" atau "Err8" muncul di layar.

Letakkan wadah atau bahan setelah 0 g/0.00 oz ditampilkan.


• Timbangan tidak disetel ke mode mikro./Tanda M menghilang ketika timbangan digunakan.


Tampilan minimum adalah 1 g/0.05 oz. Ketika total berat di nampam sebesar 1500 g/52.9 oz atau lebih, tekan sekali lagi setelah memindahkan berat.

• Walaupun berat sebesar 300g/10.58 oz atau kurang di mode mikro, satuan 0.1g/0.01oz tidak ditampilkan.

Apakah tampilan timbangan pernah menunjukkan 0 g setelah menekan  selama pengukuran tambahan? Jika jawabannya adalah "Ya", itu berarti berat total pada skala telah mencapai / melebihi 1000 g/35.28 oz.

Setelah total berat mencapai / melebihi 200 g/7.05 oz, selisih skala secara otomatis akan berubah menjadi

0.5 g/0.02 oz jika di  tekan selama pengukuran berulang. Dengan cara yang sama, ketika berat total mencapai/melampaui 1000 g/35.28 oz, kenaikan tersebut akan berubah menjadi 1 g/0.05 oz.

Untuk mengatur ulang timbangan ke cara Mikro, cukup memindahkan semua bahan dari baki kemudian  tekan untuk menunjukkan 0.0 g/0.00 oz.

Spesifikasi

		versi g	versi oz
Kapasitas		2000 g	2000 g / 70.5 oz
Skala	Mode Pengukuran Normal	1 g	1 g / 0.05 oz
	Mode Mikro	0 – 200 g 0.1 g 200 – 1000 g 0.5 g	0 – 200 g 0.1 g 0 – 7.05 oz 0.01 oz 200 – 1000 g 0.5 g 7.06 – 35.28 oz 0.02 oz

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

Modifications

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by the Tanita Corporation may void the user's authority to operate the equipment.

(EN)



Notice: These marks can be found on contaminant-containing Batteries:

Pb Pb = Battery contains lead,

Cd Cd = Battery contains cadmium,

Hg Hg = Battery contains mercury.

⚠ Not allowed to mix batteries with consumer waste!

As a consumer you are legally bound to return used or discharged batteries. You can deposit your old batteries at public collection points in your town, or wherever the corresponding batteries are sold and specifically marked collecting boxes have been set up. In case of scrapping the apparatus, the batteries should be removed from it and deposited at the collection points as well.

(ZH)



注意：含有污染物的電池上可以找到這些標記：

鉛 鉛 = 電池含有鉛，

鎘 鎘 = 電池含有鎘，

汞 汞 = 電池含有汞。

⚠ 不得與用戶廢棄的電池混合！

作為用戶你在法律上有義務歸還使用過的或是漏電的電池。可以把你的舊電池保存在你所在城市的公共收集點，或在任何有關的電池銷售點，以及已經建立的有特別記號的收集箱。在準備廢棄儀器的情況下，電池應該被移除，並且同樣存放在收集點。

(TH)



หมายเหตุ: สามารถพบสารปนเปื้อนในแบตเตอรี่:

Pb Pb = แบตเตอรี่ประกอบด้วยตะกั่ว

Cd Cd = แบตเตอรี่ประกอบด้วยแคดเมียม

Hg Hg = แบตเตอรี่ประกอบด้วยปรอท

⚠ ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วรวมกับขยะประเภทอื่น ๆ

ควรนำเครื่องหมายถึงหมอกลงสำหรับเก็บแบตเตอรี่ที่หมดอายุและต้องการทิ้ง

(IN)



Perhatian: Tanda ini dapat ditemukan pada baterai yang mengandung :

Pb Pb = Baterai mengandung lead,

Cd Cd = Baterai mengandung cadium,

Hg Hg = Baterai mengandung mercury.

⚠ Tidak diizinkan untuk mencampur baterai dengan limbah konsumen

Sebagai konsumen Anda secara hukum terikat untuk mengembalikan baterai yang digunakan atau habis.

Anda bisa menitipkan baterai lama Anda pada titik-titik pengumpulan publik di kota Anda.



EN

This device features radio interference suppression in compliance with valid EC Regulation 2004/108/EC.

ZH

該設備具有根據歐盟 2004/108/EC 規定的抑制無線電干擾作用

TH

อุปกรณ์นี้ไม่มีสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุ ในการระงับปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง 2004/108/EC

IN

Perangkat ini memiliki peredam interferensi radio sesuai dengan Peraturan 2004/108/EC yang berlaku.

Representative

TANITA Europe B.V.

Hoogoorddreef 56-E
1101 BE Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31-20- 560 -2970
Fax: +31-20 -560-2988
www.tanita.eu

TANITA India Private Limited

A-502, Mittal Commercial,
Off. M. V. Road, (Andheri Kurla Road),
Marol, Andheri - East,
Mumbai 400 059
TEL: +91 22 3192 6107
FAX: +91 22 2859 9143
www.tanita.in

TANITA (Shanghai) Trading Co, Ltd.

Room 8005, 887 Huai Hai Zhong Lu, Shanghai
The People's Republic of China
Tel: +86-21-6474-6803
Fax: +86-21-6474-7901
www.tanita.com.cn

TANITA Corporation of America Inc.

2625 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005 USA.
Tel: +1-847-640-9241
Fax: +1-847-640-9261
www.tanita.com

TANITA Health Equipment H.K. Ltd.

Unit 301-303 3/F Wing On Plaza,
62 Mody Road, Tsimshatsui East,
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2834-3917
Fax: +852-2838-8667
www.tanita.asia

Manufacturer

TANITA Corporation

1-14-2, Maeno-Cho, Itabashi-ku,
Tokyo, Japan 174-8630
Tel : +81(0)-3-3968-7048
Fax : +81(0)-3-3968-2661
www.tanita.co.jp
ISO 9001 Certified